


## ウィックガーゼ交換方法

ウィックパンにすべて収まるようにウィックガーゼを入れてください。

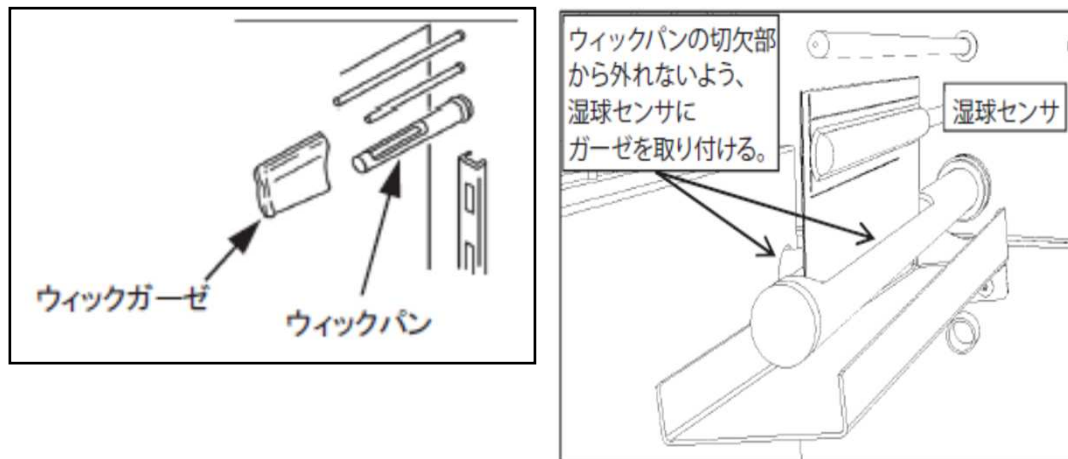

※ウィックガーゼがウィックパンからはみ出している場合、正しく湿度制御ができなかったり、加湿水消費量が多くなったりする場合があります。

※+100℃以上の温度運転を行うと、ウィックガーゼが硬化し、吸水しにくくなります。そのまま使用を継続すると、正しく湿度計測ができなくなります。

※ウィックガーゼが濡れていることを指で確認して下さい。濡れていない場合や、ウィックパンに溜まった水が溢れているような場合、水位調整方法を確認ください。

### 交換時期目安

- ・1ヶ月使用時。
- ・汚れた時、または硬化した時。
- ・100℃以上の温度運転を行った後。